
แผนการสอบเทียบ/ทวนสอบประจำปี 2569

ลำดับ	ชื่อเครื่องมือ	รหัสครุภัณฑ์	Oct-68				Nov-68				Dec-68				Jan-69				Feb-69				Mar-69				Apr-69				May-69				Jun-69				Jul-69				Aug-69				Sep-	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	ตู้ดูดความชื้น (XRD)	SSCT-0007				√												√												√												√						
2	ตู้ดูดควัน	SSCT-0009	√												√												→	√										√									
3	ตู้ดูดความชื้น (SEM)	SSCT-0014				√												√												√												√						
4	ชุดตุ้มน้ำหนัก	SSCT-0018		¥																																											
5	เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า	58-21-222900-208-00290-0001		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
6	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง	58-21-220000-208-00296-0001		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
7	ตู้แช่เย็น	58-21-220000-209-00124-0001										√																								√												
8	ตู้แช่เย็น 2	58-21-220000-209-00124-0002																						√																								√
9	อ่างควบคุมอุณหภูมิ	59-21-222900-208-00340-0001	√								√								√								√								√								√					
10	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง	60-11-220000-208-00447-0001				√								√								√								√							√								√			
11	ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ	61-11-222900-208-00351-0001											√												√												√											
12	ตู้แช่อุณหภูมิต่ำ -20 องศา	62-11-220000-202-00379-0001										√												√												√												√
13	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดผิววัตถุ	62-11-220000-202-00387-0001				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				
14	เครื่องวิเคราะห์อัตลักษณ์ด้วยคลื่นอินฟราเรด	62-11-220000-202-00353-0001				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				
15	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงพร้อมเครื่องย่อยอุณหภูมิ	62-11-220000-208-00445-0001				√								√								√								√								√										
16	เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน	62-11-220000-202-00349-0001														√																√														√		
17	เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์	63-11-220000-202-00519-0001																√																								√						
18	ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 ลิตร	63-11-222900-209-00069-0001	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√
19	เครื่องผลิตน้ำระดับห้องปฏิบัติการ	63-11-220000-202-00462-0001															○										√				○																○

ลำดับ	ชื่อเครื่องมือ	รหัสครุภัณฑ์
20	เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง (เครื่องวัดพื้นที่ผิวและความเป็นรูพรุนของตัวอย่าง)	63-11-220000-202-00578-0001
21	เครื่องวิเคราะห์สมบัติการดูดซับและปล่อยหลังการดูดซับทางกายภาพของสาร	63-11-220000-202-00578-0001
22	เตาให้ความร้อน 1	65-11-222900-202-00614-0001
23	เตาให้ความร้อน 2	65-11-222900-202-00614-0002
24	เตาให้ความร้อน 3	65-11-222900-202-00614-0003
25	ตู้ดูดควัน	65-11-222900-208-00321-0001
26	ตู้ดูดความชื้น (115)	65-11-222900-208-00522-0003
27	ตู้ดูดความชื้น (111)	65-11-222900-208-00522-0004
28	เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	65-11-222900-202-00022-0001
29	เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	65-11-222900-202-00022-0002
30	เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	65-11-222900-202-00022-0003
31	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์แบบติดผนัง	65-11-222900-208-00301-0001
32	เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง	SSCT-0019
33	เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง	SSCT-0020
34	ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์	68-11-222900-208-00715-0001

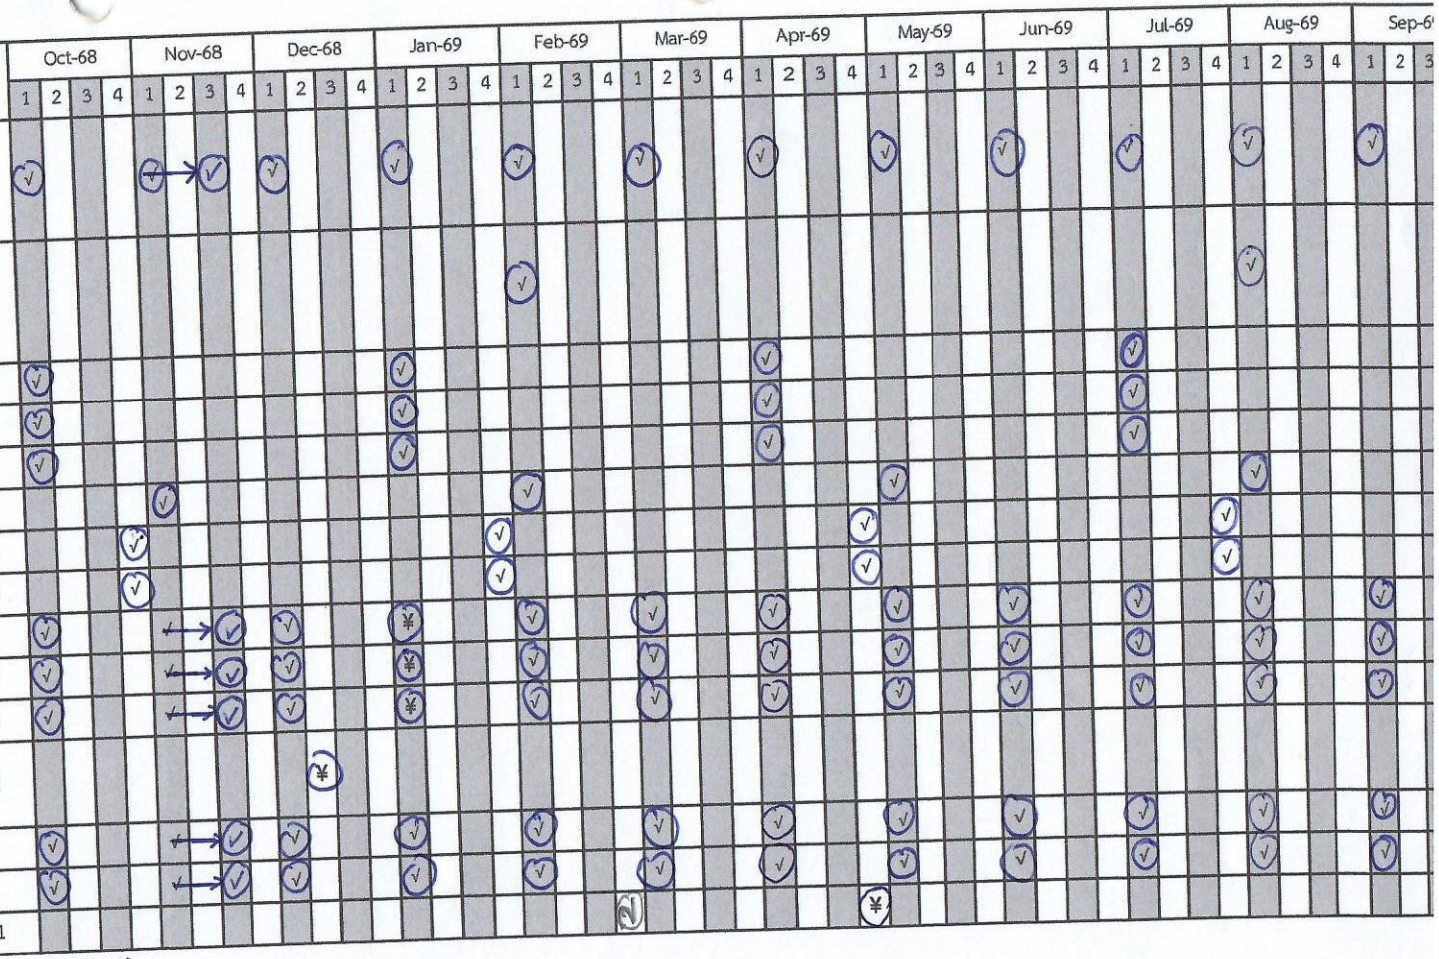

หมายเหตุ เครื่องหมาย ¥ : ส่งสอบเทียบภายนอก

√ แผน (√) ปฏิบัติจริง √→ เลื่อน

ลงชื่ออนุมัติ ..... รองผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ฝ่ายห้องปฏิบัติการและงานตรวจวิเคราะห์